sensor moet naar uw kind gericht zijn. Laat de sensorkabel onder het shirt door lopen. Om te controleren op gevallen van bedplassen, plaatst u de sensorstekker in het sensoraansluitpunt. De alarmunit zal tweemaal piepen om aan te geven dat een succesvolle connectie werd uitgevoerd.

ALARM BEHEREN & HERBRUIKEN

Om een actief alarm te stoppen, koppelt u de sensor van het alarm unit en druk kort op de programmaschakelaar. De alarmlichten en/of tonen zullen ophouden en geven aan dat de alarmunit zich in stand-by modus (energiebesparing) bevindt. Spoel beide oppervlakken van de sensor af met warm water en droog met een zachte doek. Vervang natte/vuile kleding en plaats de alarmunit en de sensor opnieuw om te blijven controleren gedurende de resterende nachtelijke tijd.

ONDERHOUD

Maak de sensor los van de alarmunit wanneer u deze overdag opbergt. De alarmunit piept eenmaal en gaat in stand-by (energiebesparing) modus.

Chummie Alarmunit

De alarmunit is niet waterbestendig; houd deze altijd droog. Vermijd contact met vloeistoffen. Dompel de alarmunit niet onder in water. Bedien deze niet met natte handen. Om de alarmunit te reinigen, dient u deze voorzichtig schoon te maken met een

IntelliFlex Sensor

Na elk gebruik, dient u de beide oppervlakken af te spoelen met warm (geen heet) water en te drogen met een zachte doek. Gebruik geen zeep of detergenten. Trek niet aan de sensorkabel. Doorboor de sensor niet, snijd er niet in en kras de sensor niet. Dompel de sensor niet onder in water.

LANGDURIG BEWAREN

Het Chummie alarmsysteem voor de behandeling van bedplassen is ontwikkeld om te functioneren bij temperaturen tussen 30°F-120°F (0°C-50°C). Indien het systeem gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, koppel de sensor dan los van de alarmunit, verwijder de batterijen uit de alarmunit en berg deze op in een koele, droge plaats.

VERVANGEN VAN BATTERIJEN & VERWERKING

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang oude batterijen door nieuwe AAA batterijen. Installeer de batterijen zoals aangegeven zodat de polen op één lijn staan met de polen van het batterijencompartiment. Verwerk gebruikte batterijen zoals voorgeschreven wordt door de lokale milieuregelgeving. Verwerk de alarmunit en de sensor op dezelfde manier als niet-gevaarlijke elektronische producten.

WAARSCHUWINGEN

Het Chummie alarmsysteem voor de behandeling van bedplassen is geen speelgoed; houd het uit de buurt van kinderen. Het luide alarm kan uw kind doen opschrikken bij het ontwaken; neem gepaste voorzorgen om uw kind te doen wennen aan de alarmtonen. Laat de kabelsensor altijd onder het shirt door lopen. De sensor is niet ontwikkeld voor meerdere gebruikers. Zorg voor een goede hygiëne door een nieuwe sensor te gebruiken voor elk kind dat behandeld wordt. Reinig de alarmunit en de sensor elke nacht voor gebruik.

GARANTIE

Theos Medical Systems biedt, vanaf de aankoopdatum en bij normaal gebruik, een garantie van 1 jaar op de Chummie alarmunit en een garantie van 3 maanden op de IntelliFlex sensor voor defecten tengevolge van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie kan niet worden overgedragen en is niet van toepassing bij verkeerd gebruik of schade door nalatigheid. Bekijk de garantiekaart voor de volledige details.

Voor klantendienst en/of aankoop van accessoires, contacteer:

THEOS MEDICAL SYSTEMS

2954 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054, USA.
Tel: (408) 239-4050. Fax: (408) 599-3020
Toll free: (800) 230-6775 (USA)
email: support@chummie.com
www.chummie.com

EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Chummie overstijgt de vereiste prestaties, constructie en veiligheidsvoorschriften. De alarmunit wordt aangedreven door batterijen en is dubbel geïsoleerd voor bijkomende bescherming. Verliesstroom op de sensor is minder dan vereist voor medische heelkundige toestellen: minder dan 8µA onder elke omstandigheid; minder dan 1µA wanneer de sensor nat is.

Chummie, IntelliFlex, One Drop Detection, Better Technology for Faster Treatment, Flexitape, Active Guard Monitoring, Enhanced Protection Plus Care, SmartFit en de Chummie en Theos Medical Systems logos zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Theos Medical Systems, Inc.

VS patenten: 8,237,573, 8,253,573. VS en Internationale patenten in aanvraag. PN/Ref.: TCE25. Doc.: TCE25-MN-DT-1. Herzieningsdatum: 04/2014. Ontwikkeld in de Verenigde Staten. Geproduceerd in China.

© 2014 Theos Medical Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

CHÜMMIE®

Behandelingssysteem Voor Enuresis

NEDERLANDS

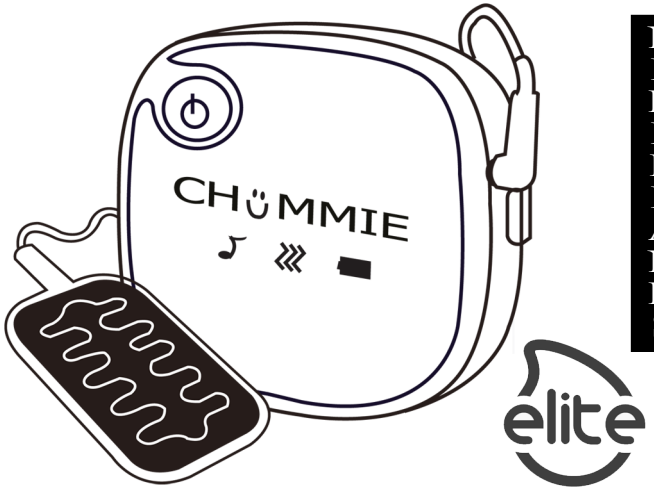

Model TCE25

Gebruiksaanwijzing en Snelstartgids (Nederlands)

www.chummie.com

Het Chummie enuresis-alarm wordt gebruikt om nachtelijk bedplassen (nachtelijke enuresis) te behandelen bij kinderen van vier jaar of ouder. Wanneer een kind in bed plast, detecteert de sensor urine en zal de alarmunit piepen, trillen en knipperen om uw kind wakker te maken. Uw kind zal geleidelijk geconditioneerd raken om op die manier sneller wakker te worden wanneer het in bed plast en het zal uiteindelijk ontwaken alvorens in bed te plassen. Om te voorkomen dat uw kind steeds gewend aan een bepaald alarm, kan het alarm unit vijf verschillende tonen afspelen en gebruikers kunnen de vibraties onder controle. Maak gebruik van het progressiedagboek om de vooruitgang van uw kind op te volgen. Een succesvolle behandeling vereist volharding en positieve bevestiging en kan enkele maanden in beslag nemen. Chummie dient elke nacht gebruikt te worden tot 14 opeenvolgende droge nachten worden bereikt, waarna het programma kan worden stopgezet.

Inhoud van de set

Chummie alarmunit, IntelliFlex sensor, bevestigingsbeugel, Flexitape, 2 AAA batterijen, gebruiksaanwijzing & snelstartgids, progressiedagboek, prestatiebeloning, garantiekaart.

SNELSTARTGIDS

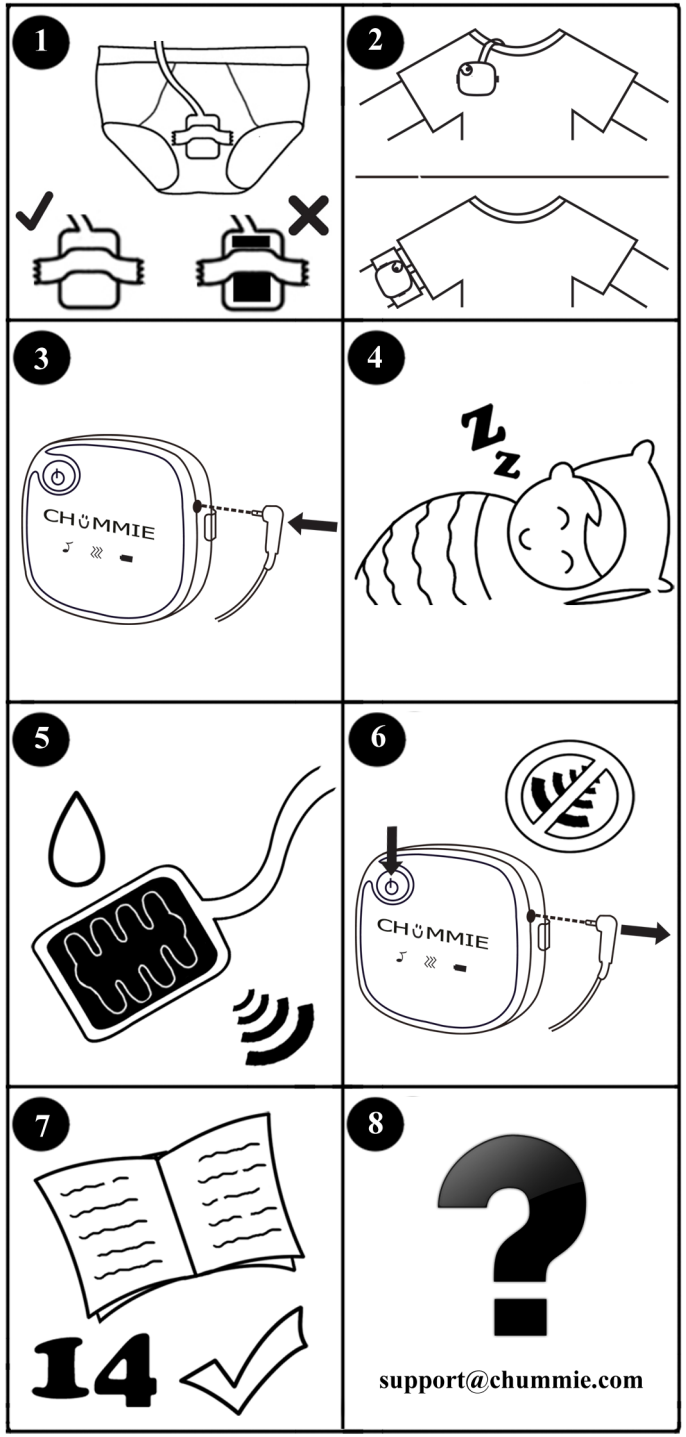

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

KEN UW CHUMMIE

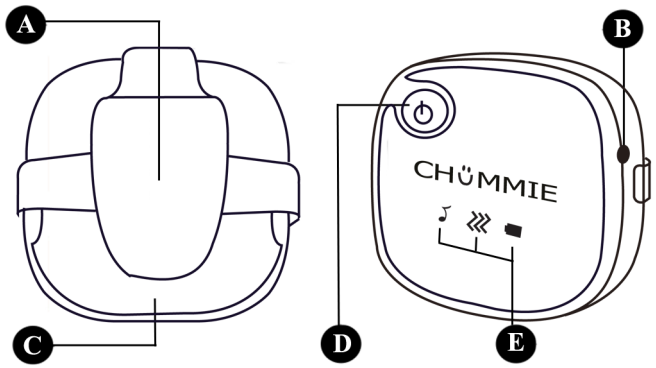

A - Bevestigingsbeugel
B - Sensoraansluitpunt
C- Batterijdeur
D - Programmaschakelaar
E - Smart LED's

INSTALLEREN VAN BATTERIJEN

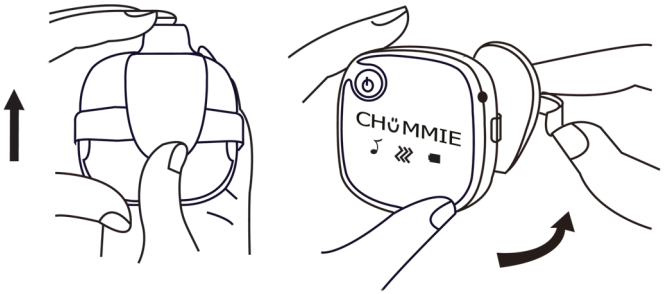

Verwijder de bevestigingsbeugel aan de achterzijde van de alarmunit door de beugel omhoog te duwen of door de alarmunit los te maken van de zijkanten van de beugel. Open de deur van het batterijencompartiment door deze in de richting van de onderkant van de alarmunit te schuiven. Installeer de 2 AAA batterijen (inbegrepen). De alarmcentrale wordt ingeschakeld. Het geluid en trillen pictogrammen oplichten en systeem piept en trilt gedurende 1 seconde. Schuif de deur van het batterijencompartiment voorzichtig in de richting van de bovenkant van de alarmunit om te sluiten. Breng de bevestigingsbeugel

Na elk gebruik, spoel beide oppervlakken van de sensor met warm water uit de kraan en dep droog. Gebruik geen zeep.

Tonen worden gewijzigd door de alarmcentrale telkens wanneer de sensor wordt losgekoppeld en weer aangesloten.

Als de rode LED op de alarmunit gloeit, de batterijen zwak zijn. Vervang de batterijen onmiddellijk.

INSTELLEN VAN TONEN, VOLUME & TRILLING

U kunt kiezen uit 3 alarm configuraties selecteren: geluid en trillingen, geluid en alleen trillen. Om het alarm configuratie selecteert, koppelt u de sensor van het alarm unit door het verwijderen van de sensor stekker van de sensor-aansluiting en volg de onderstaande stappen.

- ♦ Geluid en trillen modus: Druk op de programmaschakelaar totdat het alarm systeem piept en trilt tegelijk. Zowel geluid (gren) en trillen (amber) gaan knipperen.
- ♦ Sound mode: Om het geluid in te schakelen en uit te schakelen trillingen, druk op de programma schakelaar zolang het alarm systeem piept en trillingen wordt uitgeschakeld. Alleen het pictogram geluid (groen) knippert.
- ♦ Discreet mode: Om trillingen te schakelen en het geluid uit te zetten, druk op de programma schakelaar zolang het alarm unit trilt en het geluid wordt uitgeschakeld. Alleen het pictogram Trillen (amber) knippert.

De alarmtoon laatst gespeeld is geselecteerd en het apparaat na de laatste aanpassing van de programma schakelaar stand-by-stand (stroombesparing) modus 10 seconden.

INSTALLEREN VAN ALARMUNIT & SENSOR

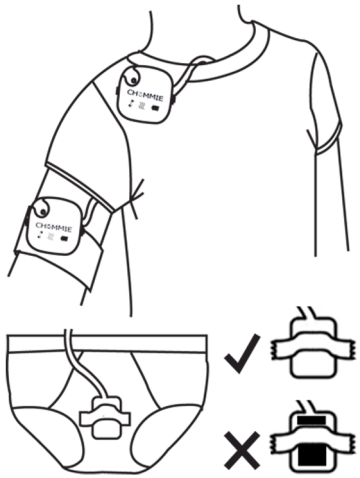

Maak de alarmunit vast ter hoogte van de kraag of rond de arm met een optioneel bijhorende armband (afzonderlijk verkrijgbaar).

Maak de sensor vast aan de buitenkant van de onderkleding van uw kind. Zorg ervoor dat de voorzijde van de sensor (zwarte zijde) de onderkleding raakt. Maak de achterzijde van de sensor (witte zijde) vast met Flexitape (inbegrepen). U kan ook de sensor vastmaken tussen twee lagen onderkleding indien gewenst. De voorzijde van de

Om de levensduur van de batterij, koppelt sensor loopt van het alarm als deze niet in gebruik is.